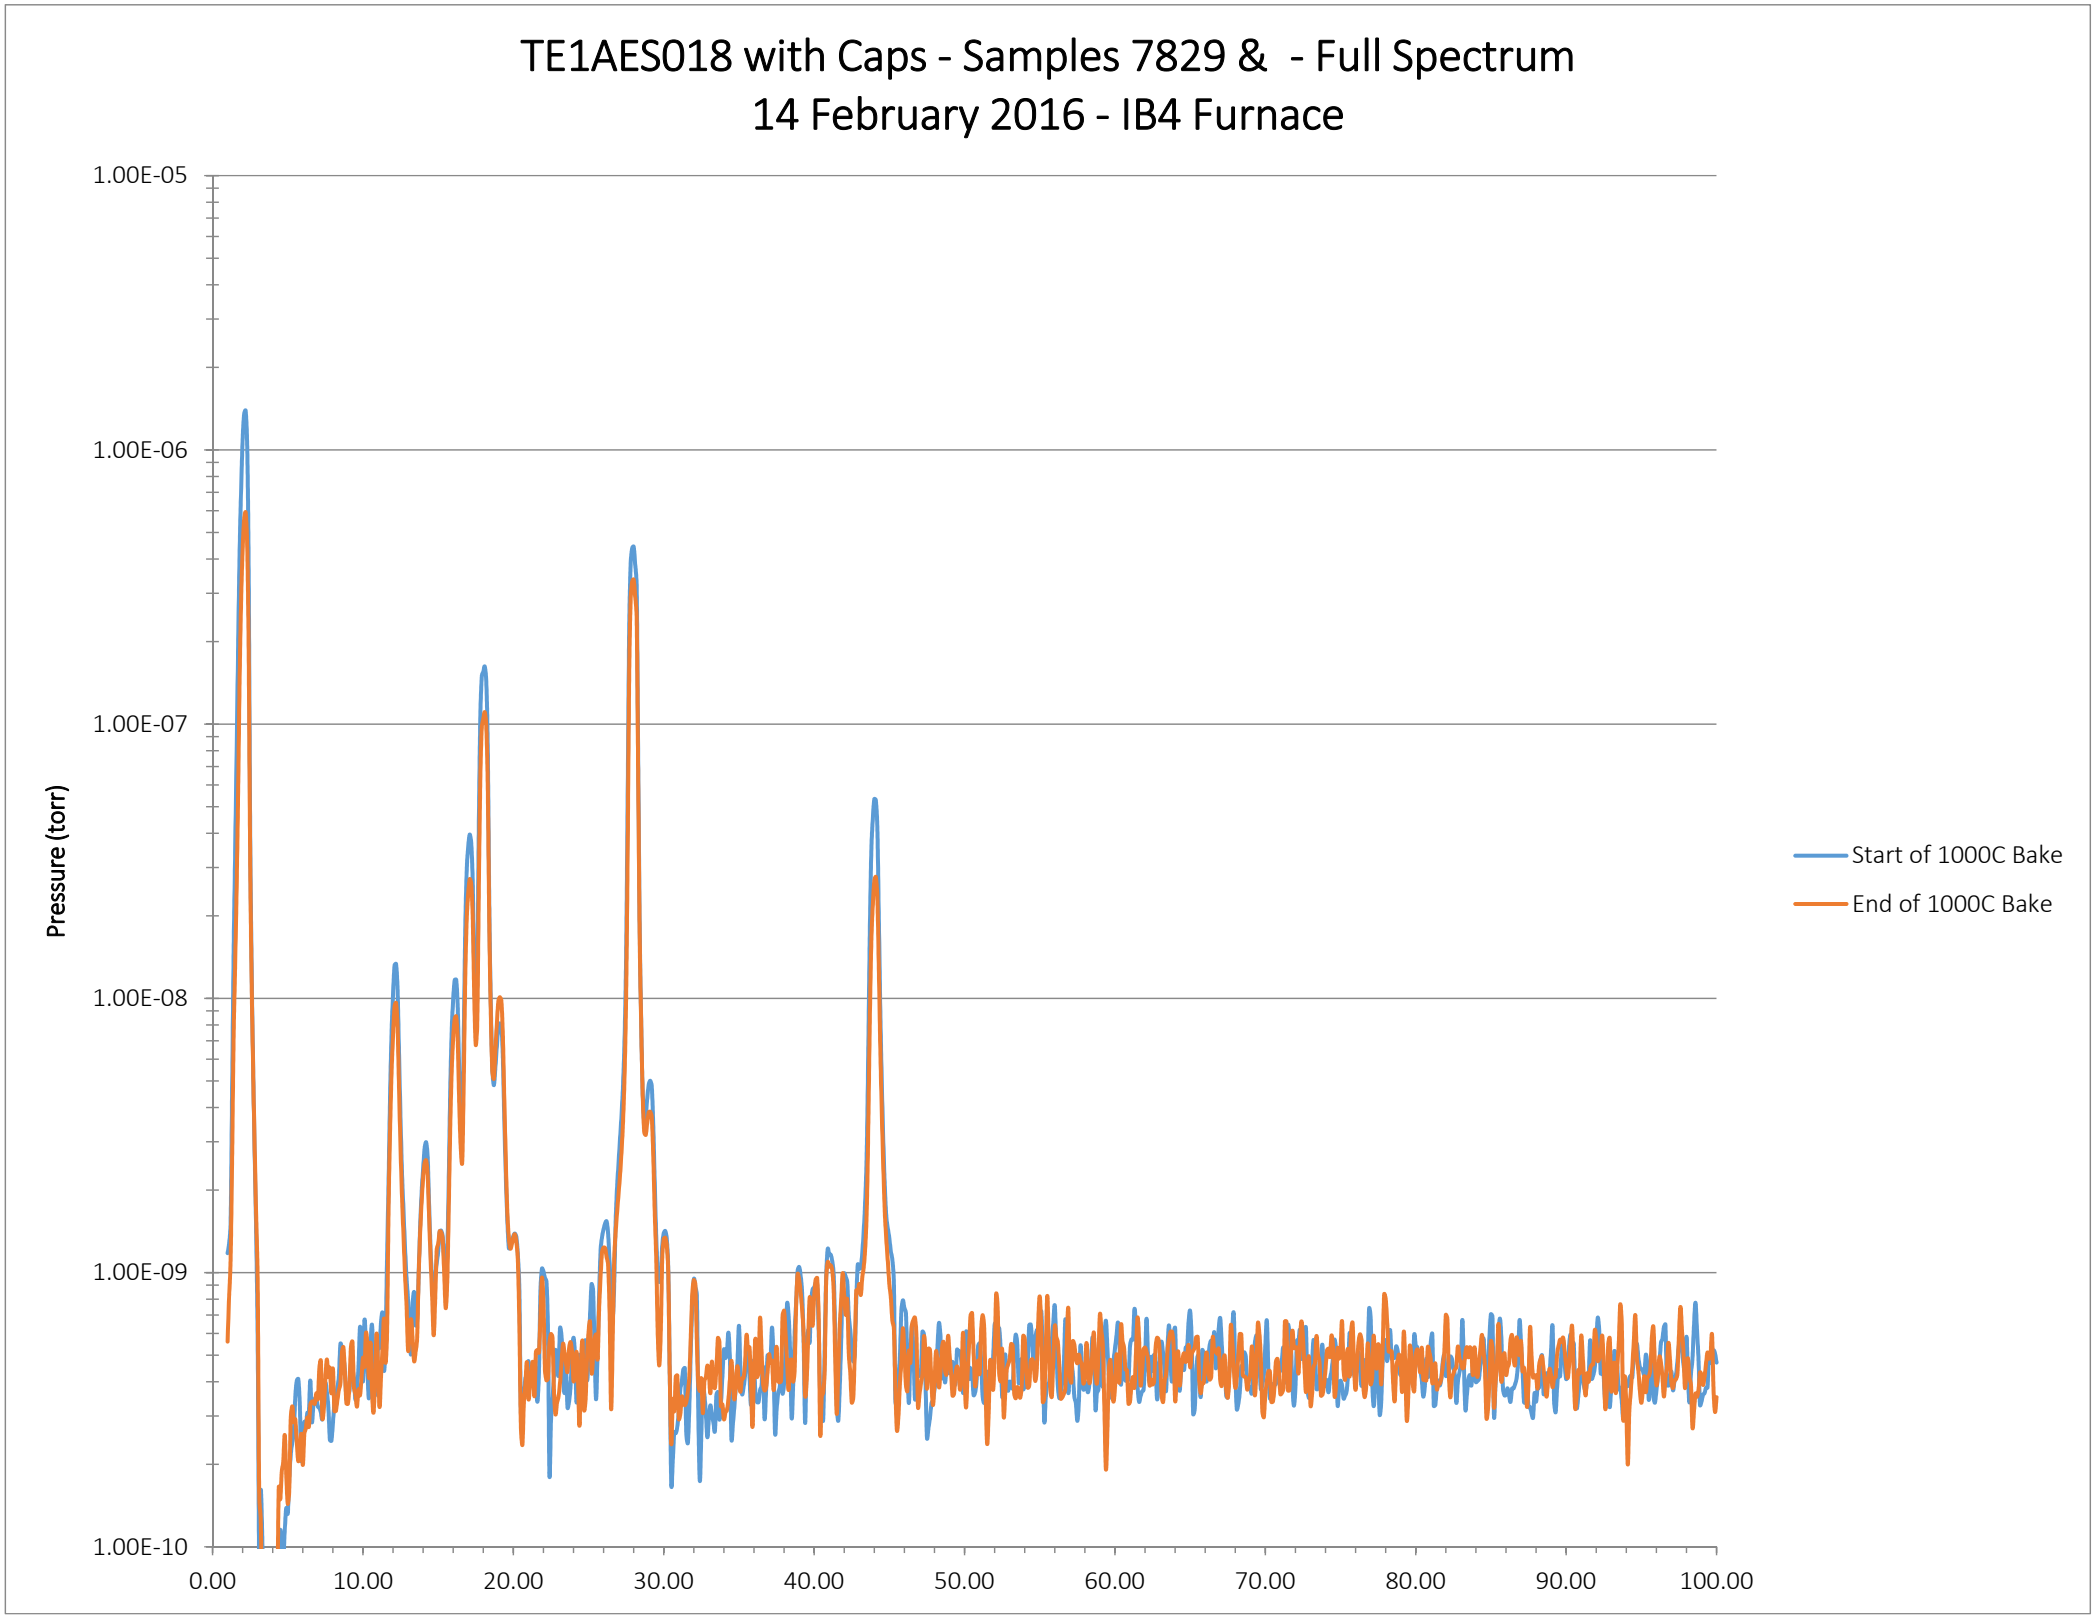
TE1AES018 with Caps - Samples 7829 & - Full Spectrum
14 February 2016 - IB4 Furnace
Pressure (torr)
1.00E-05
1.00E-06
1.00E-07
1.00E-08
1.00E-09
1.00E-10
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Start of 1000C Bake
End of 1000C Bake