9 CELL THICKNESS MEASUREMENT - MANUAL FILL-IN SHEET

Cavity ID	TB9AES017
Date	6/1/16
Technician	BS/CB
NOTES	

E1	1093	E2	1123	E3	1102	E4	1122	E5	1115
I1L	1032	I2L	1027	I3L	1064	I4L	1040	I5L	1018
I1R	1065	I2R	1035	I3R	1057	I4R	1076	I5R	1027

E6	1089	E7	1088	E8	1087	E9	1106		
I6L	1057	I7L	1065	I8L	~~1062~~ 1033				
I6R	1060	I7R	1055	I8R	~~1147~~ 1062				

BT1 1138

BT2 1147

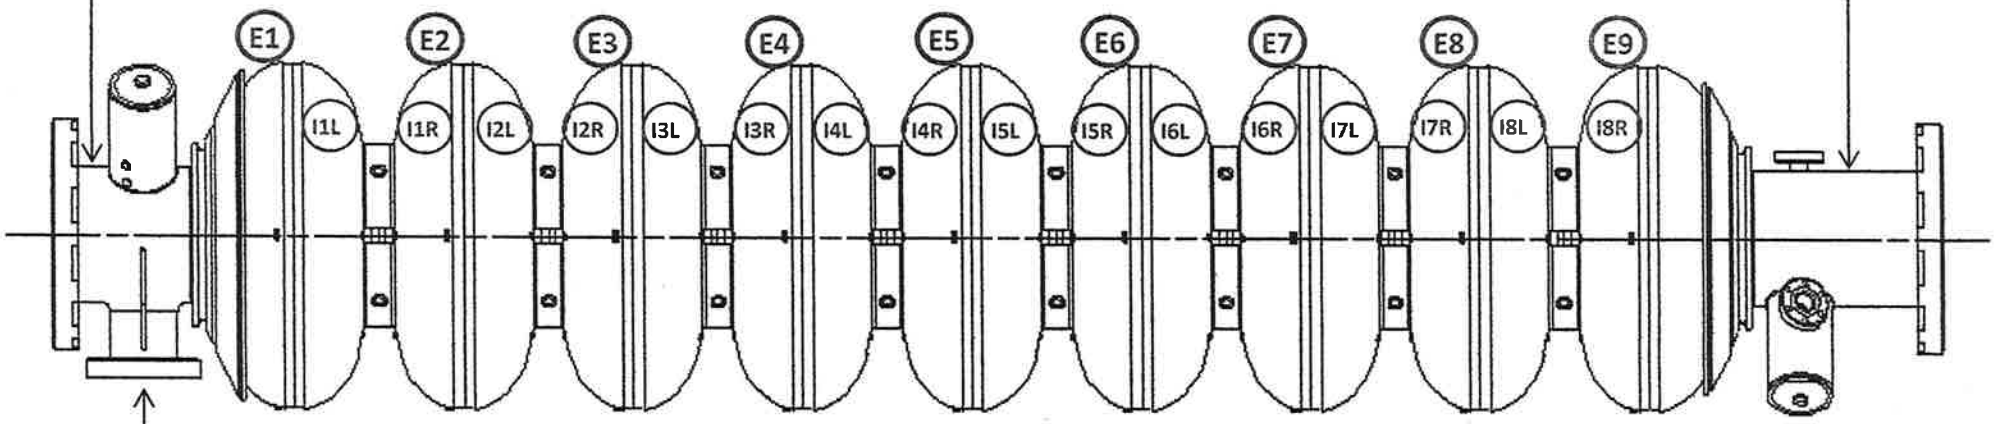

FPC

Weight Differential

Before Weight (g)	
After Weight (g)	
Avg. Removal (um)	0

scale not working - needed recharge

C. Baker 9/14/2011